
# 機械器具25 医療用鏡

一般医療機器 内視鏡用送水タンク JMDNコード:36500042

# 送水タンク WT-2

### 【形状・構造及び原理等】

### <形状>

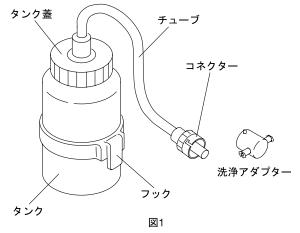


### <構造・構成ユニット>

# 標準付属品

洗浄アダプター: CA-01T

### く作動・動作原理>

内視鏡の送気送水管路は常にポンプより空気が供給されています。 (図2参照)

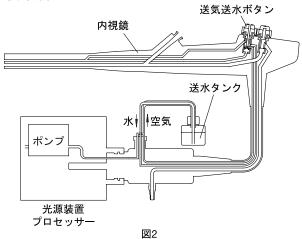


送気送水ボタンの穴を塞ぐことにより先端までの管路がつながり 先端より空気が吹き出します。

## (図3参照)

更に送気送水ボタンを押し込むと、送気管路が塞がれ、空気は送 水タンクに流れ込みます。空気は送水タンク内の水を押し出し、 水は管路内を流れ、先端より吹き出します。

(図4参照)



# 【使用目的、効能又は効果】

本製品は、医師の管理下で医療施設において、内視鏡用の送水装置等に接続する送水用の貯水タンクです。

## 【品目仕様等】

項目	諸 元		
全長	630mm		
タンク外径 (フックは含まず)	62mm		
容量	250ml		
適用可能な滅菌方法	オートクレーブ滅菌		

# 【操作方法又は使用方法等】

# <使用方法>

- (1) 用途に適したレベルの消毒、滅菌を行います。
- (2) 送水タンクの外観やチューブに著しい変形等の異常が無いことを確認します。
- (3) 送水タンクに8分目くらいまで滅菌水を注ぎ、蓋をします。
- (4) 送水タンクのフックを光源装置、プロセッサー、またはカート の送水タンクフックに掛けます。
- (5) 送水タンクのコネクターを内視鏡の送水コネクターに差し込みます。
- (6) コネクターの溝と内視鏡側のピンを合わせて、止まるところまで時計回りに回して固定します。
- (7) 送水できることを確認してから内視鏡検査を行います。
- (8) 検査終了後、内視鏡を抜去してから機器の電源を切ります。
- (9) 送水タンクのコネクターを反時計回りに回して、内視鏡の送水コネクターから引き抜きます。
- (10) 送水タンクを外し、残っている水を捨てます。

### <組み合わせて使用する医療機器>

本製品は以下の医療機器と組み合わせて使用します。 内視鏡:送気送水機能付きフジノン内視鏡

取扱説明書を必ずご参照ください。

# 【使用上の注意】

#### く使用注意>

#### 使用前の点検

- ・不測の事故を回避し、機器の性能を充分に発揮してお使いいただくために、使用前の点検を行ってください。
- ・点検の結果、異常があったものは使用しないでください。

#### 機器の組み合わせ

・送水タンクは、送気送水機能付きフジノン内視鏡と組み合わせ て使用します。組み合わせ以外の内視鏡には使用しないでくだ さい。

#### 洗浄と消毒

・送水タンクは、あらかじめ滅菌が行われておりません。初めて 使用するときは、用途に応じたレベルの消毒または滅菌を行っ てください。

また、再使用する前には、洗浄・消毒または滅菌を行ってください。不充分な洗浄は、感染の原因になります。皮膚の保護、感染防止のため、薬液洗浄・消毒の際には保護具をご使用ください。

#### <重要な基本的注意>

#### 手入れ方法

- ・消毒、滅菌が不十分になるおそれがあります。使用後は直ちに 洗浄してください。
- ・消毒液の蒸気は、人体に悪影響を与えるおそれがあります。消毒を行うときは、十分に換気してください。浸漬槽のふたを閉めて浸漬してください。
- ・送水タンクの水は滅菌水を使用し、毎日入れ替えてください。

### 保管

・感染のおそれがあります。送水タンクは、乾燥してから保管してください。

### 廃棄

・廃棄する場合は、地域の法規制に従って廃棄してください。感染性廃棄物に該当するかにつきましては、ご使用の状態によってご判断ください。

# 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

## <貯蔵・保管方法>

薬液消毒または滅菌した送水タンクを保管します。送水タンクは 以下の条件を満たす所で保管してください。

保管条件

温度: -10~45℃

湿度:30~95%RH(ただし、結露状態を除く)

気圧:70~106kPa (大気圧範囲)

# <有効期間・使用の期限(耐用期間)>

有効期間(耐用年数)は適切な保守点検を行い、正しく使用した場合、3年間です。

「自己認証(当社データ)による」

# 【保守・点検に係る事項】

長期間使用しておりますと、機器も傷んでまいります。特にゴムや樹脂等の部分は、使用薬剤や経時変化によっても劣化します。 使用前の点検を行ってください。

#### 【包装】

1個/箱

製造販売業者

富士フイルム株式会社

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地

TEL: 0120-771669

製造業者

株式会社金子製作所

埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場1-3-13

TEL: 048-794-8111

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社 東京都港区西麻布二丁目26番30号

 $\mathbf{TEL}: 03\text{-}6419\text{-}8033$ 

販売店			